



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

~~BOZZA~~

ACCORDO AZIENDALE

INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO  
SALA ANGIOGRAFICA 2 SITA ALL'OSPEDALE "M. BUFALINI" DI CESENA  
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 4 LEGGE N. 300/1970 E SS.MM.II.

Tra

L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - AMBITO DI CESENA

- DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA, SANITARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
- DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA
- AREA COMPARTO SANITÀ E RSU AZIENDALE

Richiamati:

- L'art. 4 della Legge n. 300 del 20/05/1970 "Statuto dei lavoratori", novellato dall'art. 23 del Decreto Legislativo n. 151 del 15/09/2015 che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, prevedendone l'ammissibilità solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e, più precisamente, il comma 3 art. 4 Statuto dei lavoratori citato per quanto riguarda la disciplina della raccolta delle informazioni attraverso gli impianti audiovisivi e altri strumenti la quale stabilisce che venga utilizzata a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore riceva adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di svolgimento dei controlli nel rispetto della vigente normativa;
- il Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27.04.2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (GDPR) che ha avuto piena applicazione a far data dal 25.05.2018;
- il D.Lgs. 101 del 10.08.2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";
- il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 101 del 10.08.2018;

3. All'Univ  
Javier  
Bedon

1

u

- il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010, compatibile, ai sensi dell'art. 22 Del Decreto di adeguamento (D. Lgs. 101/2018 sopracitato), con l'attuale assetto normativo previsto dal Regolamento UE;
- la deliberazione n. 568 del 22/12/2016 di istituzione della Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza come integrata dalla deliberazione n. 345 del 26/9/2018.

Premesso che si rende necessario per esigenze di tipo clinico ed in via subordinata a saltuari fini didattico/divulgativi provvedere all'installazione di n. 2 telecamere per la videoregistrazione dell'area afferente il campo operatorio.

Considerato che le due telecamere saranno poste rispettivamente: l'una all'interno della lampada sialitica che riprende solo esclusivamente il campo operatorio e l'altra in posizione frontale rispetto al lettino su cui sarà posizionato il paziente e il cui campo di ripresa sarà circoscritto solo esclusivamente al campo operatorio e allo strumentario.

Osservato che l'impianto oggetto del presente accordo sarà dotato anche di trasmissione audio a scopo didattico/divulgativo e che è prevista la possibilità di condividere le immagini riprodotte dalle telecamere al sistema intranet aziendale dell'ospedale, proteggendo il sistema di trasmissione delle immagini, contro i rischi di accesso abusivo, mediante opportuni sistemi di password.

Precisato che l'impianto di videosorveglianza sarà attivato esclusivamente dal personale durante l'esecuzione dell'esame del paziente; ad impianto acceso, si attiverà automaticamente la registrazione delle immagini che saranno conservate per un tempo pari a 3 giorni (72 ore) trascorsi i quali le immagini saranno cancellate/sovrascritte dalle ultime acquisite. Occasionalmente le immagini delle telecamere potranno essere trasmesse via web, per finalità esclusivamente didattico/formative, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Dato atto che il presente impianto è finalizzato esclusivamente, come già precisato, per scopo clinico e secondariamente a saltuari scopi didattici/divulgativi, rispettando la tutela della riservatezza e della dignità del paziente consenziente.

Considerato che sarà anticipatamente raccolto il consenso degli operatori, ogni volta che le immagini saranno registrate o diffuse, oltre al consenso da parte del paziente, previo rilascio di idonea informativa agli stessi, in relazione alle finalità perseguite con la ripresa (scopo clinico e/o didattico). Nel contempo, viene garantito che l'eventuale ripresa del dipendente durante lo svolgimento della propria attività lavorativa non potrà essere utilizzata ai fini di controllo a distanza della attività dei lavoratori e di relativi addebiti, essendo l'impianto finalizzato a soli scopi clinici e didattici, in relazione alla specifica attività di cura.

Valutato che il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione del sistema di videosorveglianza in locali di proprietà dell'Azienda, si svolgerà nel rispetto di diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, a tal fine verrà posta particolare

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like C. Oliva, P. P. P., and others.]*

attenzione nelle fasi di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Saranno, inoltre, installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza e l'informativa sul trattamento dei dati; la registrazione delle immagini

Dato atto della positiva valutazione espressa con nota prot. n. 221177/P dalla preposta Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza in merito all'istanza di installazione impianto di videosorveglianza presso U.O. di Neuroradiologia – Sala Angiografica 2 dell'Ospedale "Bufalini M." di Cesena (FC)

Dato atto che la Commissione Aziendale per la gestione dei sistemi di Videosorveglianza ha valutato che il progetto così formulato rispetta i principi e le finalità previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;

LE PARTI SI ACCORDANO :

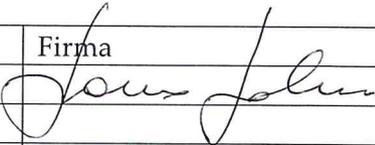
sull'installazione di un impianto di videosorveglianza presso U.O. di Neuroradiologia – Sala Angiografica 2 dell'Ospedale "Bufalini M." di Cesena (FC) come da progetto di installazione impianto e relativa planimetria, parte integrante del presente accordo.

NORMA DI SALVAGUARDIA




Eventuali modifiche od integrazioni dovessero successivamente intervenire, nel rispetto dei principi elencati nel presente Accordo, saranno oggetto di preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza, del Comparto ed alla RSU aziendale.

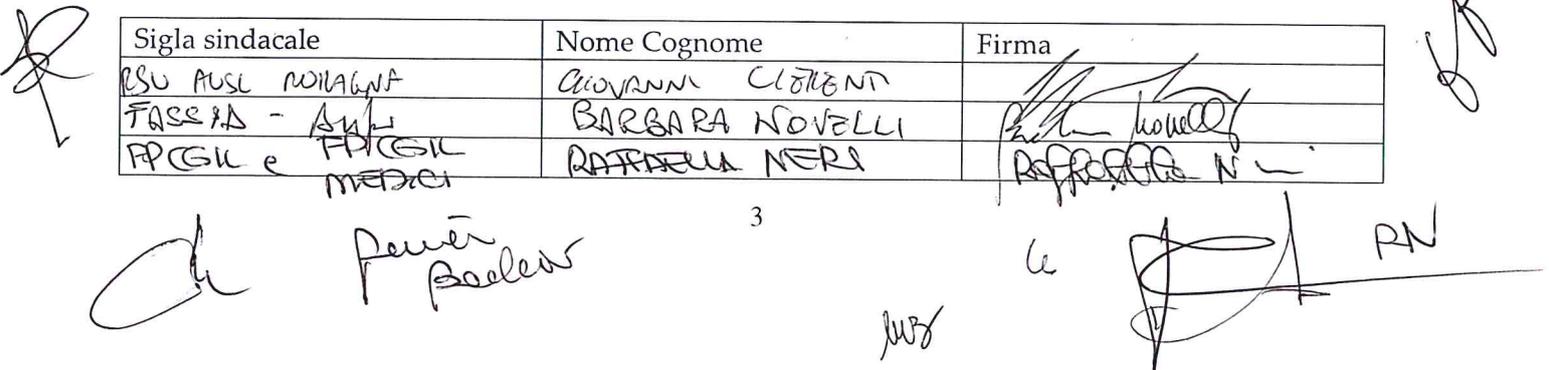
Cesena, 10/12/2019

Per la delegazione di parte pubblica


		Firma
Direttore Amministrativo	Franco Folini	

Per le Rappresentanze Sindacali Dirigenza Medica e Veterinaria, Dirigenza Sanitaria e delle Professioni Sanitarie, Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa e Area Comparto

Sigla sindacale	Nome Cognome	Firma
RSU AUSL Romagna	GIOVANNI CLORENTI	
FASISA - AUSL	BARBARA NOVELLI	
APCGIL e FIPCGIL medici	DARDELLA NERI	







**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA AL PROGETTO DI NUOVO SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO SALA ANGIOGRAFICA 2 PRESSO OSPEDALE  
"BUFALINI M." DI CESENA.**

*per accordo sindacale ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 300/1970, così come modificato  
dall'art. 23 del D.Lgs 151/2015*

**Breve premessa esplicativa del tipo di richiesta avanzata**

Nel reparto di Neuroradiologia presso il Presidio Ospedaliero "Bufalini M." di Cesena, contestualmente all'installazione di nuovo agiografo presso la "Sala Esame 2", verranno fornite, unitamente ad altre apparecchiature elettromedicali, n. 2 telecamere per la videoregistrazione dell'area afferente il campo operatorio, a scopo clinico ed in via subordinata a saltuari fini didattico/divulgativi.

Il sistema sarà costituito da:

- n.1 telecamera analogica installata all'interno della lampada scialitica;
- n.1 telecamera digitale ambientale PTZ mobile installata in controsoffitto nella sala esame;

La telecamera su lampada scialitica è con sensore CCD, con zoom 10x motorizzato e risoluzione 768x576; mentre la telecamera ambientale è ad alta definizione con obiettivo con zoom 30x ottico e fino a 40x con tecnologia "Super Solution", supporto PoE+, trasmissione video HDMI e audio tramite sistema IP, controllo telecamera tramite IP.

Il dispositivo di gestione/registrazione, detto DVR, sarà di tipo IP con 4 ingressi e dotato di Hard Disk per acquisire le immagini. L'unità funziona da Scaler ed Embedder audio e permetterà l'output del segnale simultaneamente su HDMI e su HDBaseT e saranno inclusi ingressi e uscite audio analogiche. Tramite l'interfaccia LAN, che sarà connessa al registratore mediante cavo HDMI, ci sarà la possibilità di condividere le immagini riprodotte dalle telecamere al sistema intranet aziendale dell'ospedale. Il DVR sarà custodito nel locale "Sala Controllo" all'interno d'idoneo armadietto chiuso a chiave, con accesso riservato al solo

U.O. complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti  
Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirrotti 286 - Cesena (FC)  
T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196  
uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it

Azienda USL della Romagna  
Sede legale: Via De Gasperi, 8  
48121 Ravenna  
Partita iva 02483810392

personale autorizzato. Il sistema di videosorveglianza sarà attivato esclusivamente dal personale durante l'esecuzione dell'esame al paziente; ad impianto acceso, si attiverà automaticamente la registrazione delle immagini che saranno conservate per un tempo pari a 3gg (72 ore), trascorsi i quali le immagini saranno cancellate/sovrascritte dalle ultime acquisite. Occasionalmente le immagini delle telecamere potranno essere trasmesse via web, per finalità esclusivamente didattico/formative, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Il monitor LCD di visualizzazione sarà installato all'interno della sala esame, adiacente al lettino su cui sarà posizionato il paziente; tale monitor sarà attivato al bisogno dal personale autorizzato. Mentre il monitor di visualizzazione/consultazione sarà installato all'interno della sala controllo, in prossimità della postazione di lavoro del personale medico ed anch'esso sarà attivato al bisogno dal personale autorizzato.

All'interno dei locali interessati saranno presenti gli appositi cartelli riportanti l'indicazione "area sottoposta a videosorveglianza" e l'informativa sul trattamento dei dati.

Il Responsabile e gli Incaricati al Trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, saranno gli unici autorizzati ad accedere ai locali in cui saranno situate le postazioni di controllo del sistema (monitor) e a visionare le relative immagini durante la rilevazione.

### CONCLUSIONI

Il presente impianto di videosorveglianza, dotato di registratore, è finalizzato esclusivamente per scopo clinico e secondariamente a saltuari scopi didattici/divulgativi, rispettando la tutela della riservatezza e della dignità del paziente consenziente.

Si precisa che sarà anticipatamente raccolto il consenso degli operatori, ogni volta che le immagini saranno registrate o diffuse, oltre al consenso da parte del paziente, previo rilascio di idonea informativa agli stessi, in relazione alle finalità perseguite con la ripresa (scopo clinico e/o didattico).

L'eventuale ripresa del dipendente durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, non potrà essere utilizzata a fini di *controllo a distanza della attività dei lavoratori e di relativi addebiti*, essendo l'impianto finalizzato a soli scopi clinici e didattici, in relazione alla specifica attività di cura.

Il progetto garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'installazione del sistema di videosorveglianza in locali di proprietà dell'Azienda, si svolga nel rispetto dei

U.O. complessa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti  
Ospedale M. Bufalini, Viale Ghirelli 286 - Cesena (FC)  
T. +39.0547.352320 - F. +39.0547.645196  
uo.tecnico.patrim.ce@auslromagna.it

Azienda USL della Romagna  
Sede Legale: Via De Gasperi, 8  
48121 Ravenna  
Partita iva 02483810392

Handwritten signature: P. Baccini

diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Particolare attenzione verrà pertanto posta nelle fasi di raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati, nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Saranno inoltre installati opportuni cartelli indicanti che l'area è sottoposta a videosorveglianza e l'informativa sul trattamento dei dati.

Il progetto come sopra descritto, rispetta i principi di liceità, necessità, proporzionalità, pertinenza e finalità.

Il titolare del trattamento dei dati raccolti sarà l'Azienda USL della Romagna.

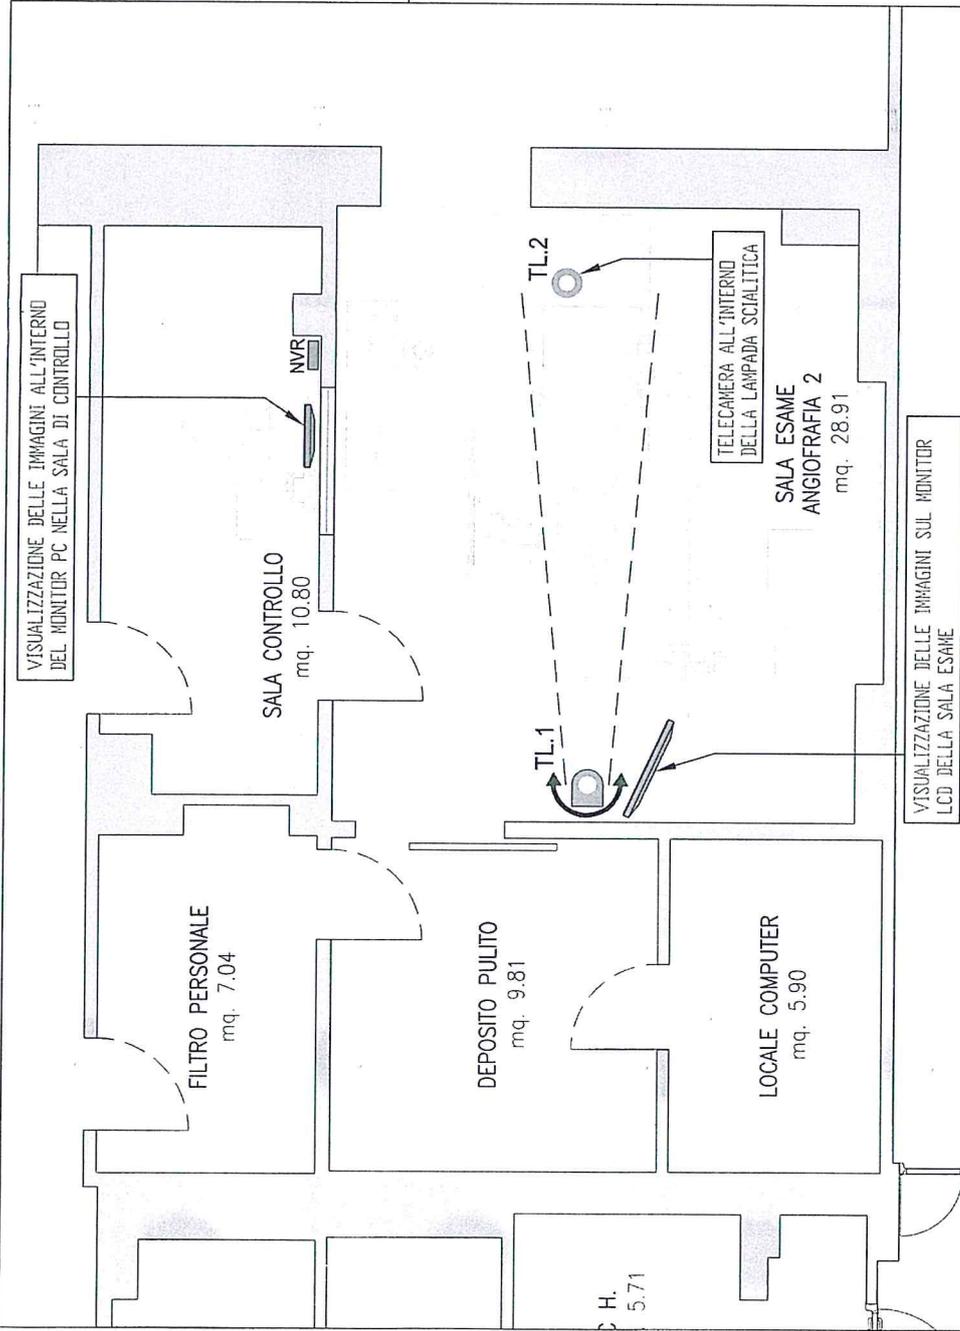
Il Responsabile del Trattamento dati raccolti sarà il Direttore della U.O. Neuroradiologia di Cesena.

*Dr. Oliva*

*Dr. B...*

*Dr. ...*

PLANIMETRIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA



**LEGENDA SIMBOLI GRAFICI**

SIMB.	Q.TA'	DESCRIZIONE PRODOTTO
	1	Telecamera ambientale PTZ mobile ad alta definizione, con zoom ottico e fino a 40x con tecnologia "Super Solution", supporto PoE+, trasmissione video HDMI e audio tramite sistema IP, controllo telecamera tramite IP. Installata in controsoffitto nella sala esame.
	1	Telecamera analogica all'interno della lampada scialitica, con sensore CCD, con zoom 10x motorizzato e risoluzione 768x576.
	1	Sistema di gestione/registrazione dell'impianto DVR, tipo PoE con 4 ingressi e dotato di Hard Disk in grado immagazzinare le riprese effettuate dalla telecamera per 72h. Installato nella sala di controllo.

**NOTA BENE:**  
L'angolazione dell'obiettivo è puramente indicativa e in fase di installazione e di programmazione dovrà essere configurata dalla ditta installatrice, al fine di videosorvegliare le aree strettamente interessate.

**RELAZIONE DESCRITTIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Il presente progetto riguarda l'impianto di videosorveglianza TVCC per controllare esclusivamente il campo operatorio per scopo clinico e saltuariamente per scopo didattico/divulgativo della Sala Angiografia 2 dell'Ospedale "Bufalini M." di Cesena. All'interno del presente locale saranno installate n.2 telecamere, di cui una telecamera ambientale in posizione frontale rispetto al lettino su cui sarà posizionato il paziente, e una installata sulla lampada scialitica. Entrambi le telecamere avranno campi di ripresa circoscritti solo esclusivamente al campo operatorio e allo strumentario. Il sistema di videosorveglianza è predisposto per funzionare in videoregistrazione, le telecamere saranno connesse mediante cablaggio strutturato al sistema Intranet aziendale dell'ospedale. Solo occasionalmente, le immagini delle telecamere potranno essere trasmesse via web per finalità esclusivamente didatticoformative, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni. L'impianto è costituito da n.2 postazioni di consultazione; la prima è composta da monitor LCD installato all'interno della sala esame, adiacente al lettino su cui sarà posizionato il paziente. Il monitor verrà attivato al bisogno dal personale autorizzato. La seconda postazione è composta da monitor LCD installato all'interno della sala controllo, in prossimità della postazione di lavoro del personale medico. Il monitor verrà attivato al bisogno dal personale autorizzato. Saranno inoltre installati gli appositi cartelli indicanti che l'area in questione è sottoposta a videosorveglianza e l'informativa sul trattamento dati.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna  
Area Dipartimentale Ricerche Strumentali e Tecnologiche  
U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti  
Direttore Ing. Claudio Piumanti

IMPIANTO SPECIALE  
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  
SALA ESAME ANGIOGRAFIA 2  
PRESSO OSPEDALE "M. BUFALINI"  
DI CESENA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: \_\_\_\_\_

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: \_\_\_\_\_

Ing.	Aziende	PREVIO
Prof. Ing.	Aziende	TWO

AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA  
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE  
IMPIANTI ELETTRICI  
P.L. Ampliare TUP  
Stalder & Suter

Rev	Data	1° EMISSIONE	Descrizione	Elaborato	Titol. A.	Titol. A.	PRIMA	PRIMA
1	APRILE 2019							

REVISIONI

SEGA ELABORATO

SCALA: \_\_\_\_\_ DATA: APRILE 2019 DISEGNO: \_\_\_\_\_

I.TVCC.PL.

*Donat Baer*

*C. Celli*